



**Mi Universidad**

# **Algoritmo de reanimación neonatal**

*Adriana Janeth Sanchez Hernández*

*Algoritmo de reanimación neonatal*

*Parcial I*

*Crecimiento y desarrollo*


*Dr. Jorge Arturo Cadenas López*

*Medicina Humana*

*Tercer semestre*

# ALGORITMO DE REANIMACIÓN NEONATAL EN SALA DE PARTOS

La acción más importante es la ventilación pulmonar. Temperatura sala de partos

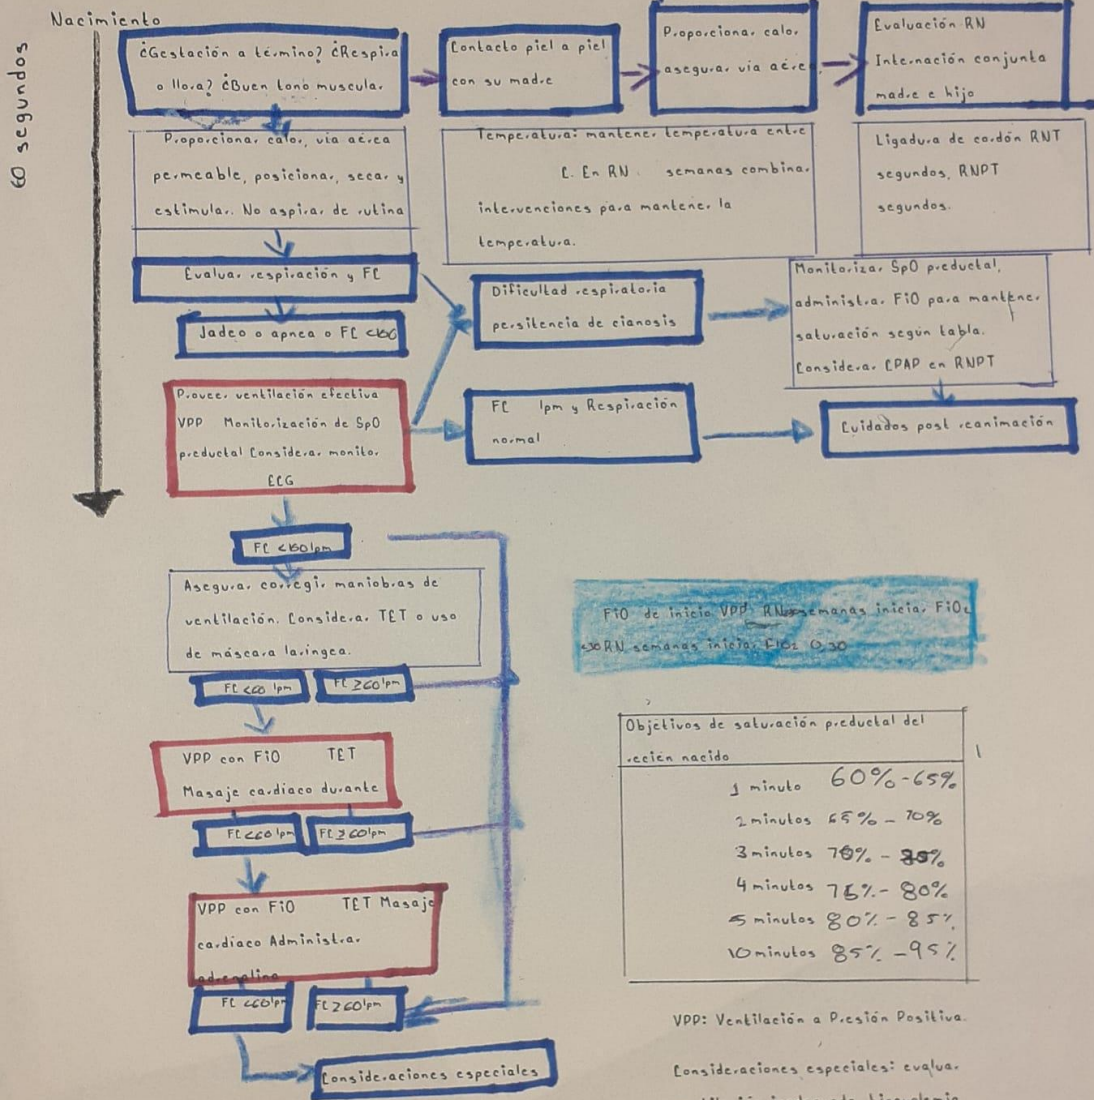

FIO2 de inicio VPP: RN < 37 semanas inicio FIO2 0.21  
 ≥ 37 RN semanas inicio FIO2 0.30

Objetivos de saturación preductal del recién nacido	
1 minuto	60% - 65%
2 minutos	65% - 70%
3 minutos	70% - 75%
4 minutos	75% - 80%
5 minutos	80% - 85%
10 minutos	85% - 95%

VPP: Ventilación a Presión Positiva.  
 Consideraciones especiales: evaluación ventilación inadecuada, hipovolemia, neumotórax, otros diagnósticos