




ALUMNO: Daniel Alexander Sanchez Morales

DOCENTE: Marcos Jhodany Arguello

MATERIA: enfermería clinica

TRABAJO: Mapa conceptual

5to cuatrimestre

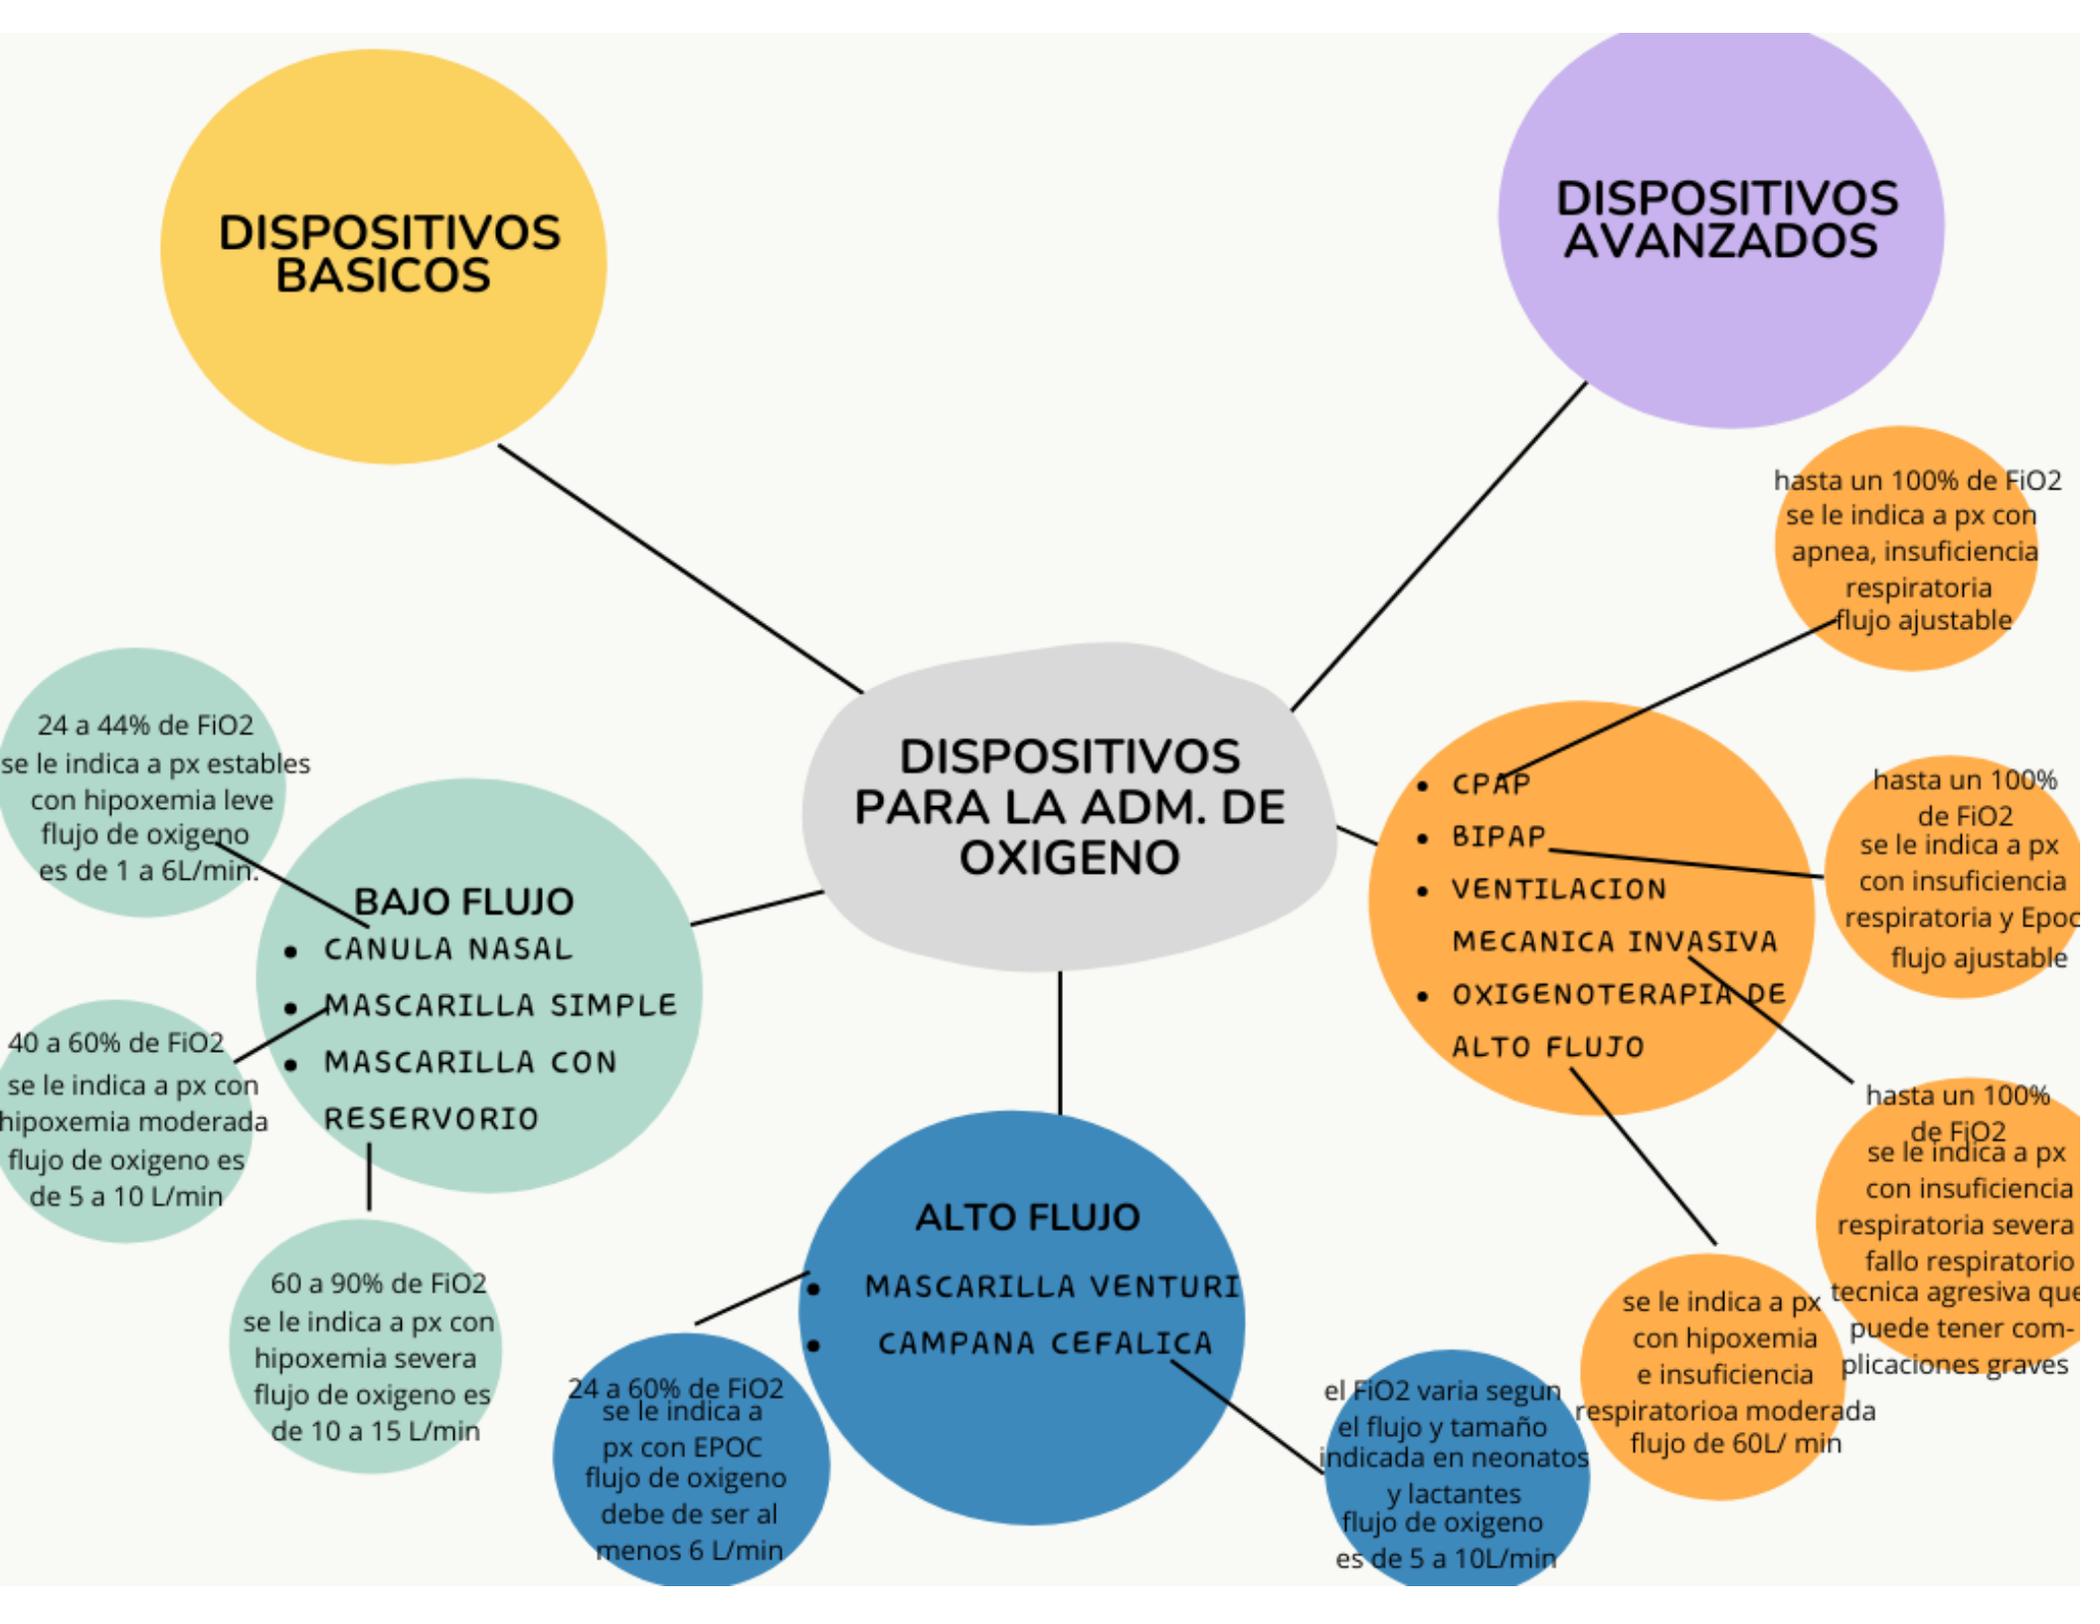

DISPOSITIVOS BASICOS

DISPOSITIVOS AVANZADOS

DISPOSITIVOS PARA LA ADM. DE OXIGENO

BAJO FLUJO

- CANULA NASAL
- MASCARILLA SIMPLE
- MASCARILLA CON RESERVORIO

ALTO FLUJO

- MASCARILLA VENTURI
- CAMPANA CEFALICA

- CPAP
- BIPAP
- VENTILACION MECANICA INVASIVA
- OXIGENOTERAPIA DE ALTO FLUJO

hasta un 100% de FiO2 se le indica a px con apnea, insuficiencia respiratoria flujo ajustable

hasta un 100% de FiO2 se le indica a px con insuficiencia respiratoria y EPOC flujo ajustable

hasta un 100% de FiO2 se le indica a px con insuficiencia respiratoria severa fallo respiratorio tecnica agresiva que puede tener complicaciones graves

se le indica a px con hipoxemia e insuficiencia respiratoria moderada flujo de 60L/min

el FIO2 varia segun el flujo y tamaño indicada en neonatos y lactantes flujo de oxigeno es de 5 a 10L/min

24 a 44% de FiO2 se le indica a px estables con hipoxemia leve flujo de oxigeno es de 1 a 6L/min.

40 a 60% de FiO2 se le indica a px con hipoxemia moderada flujo de oxigeno es de 5 a 10 L/min

60 a 90% de FiO2 se le indica a px con hipoxemia severa flujo de oxigeno es de 10 a 15 L/min

24 a 60% de FiO2 se le indica a px con EPOC flujo de oxigeno debe de ser al menos 6 L/min